













Nakuwacz i lancet

Autolanceta a lanceta

Odberové pero a lanceta

Spróžlna naprava in lanceta Lancetar i lanceta

DE 0920988001 (02) – US 0920988002

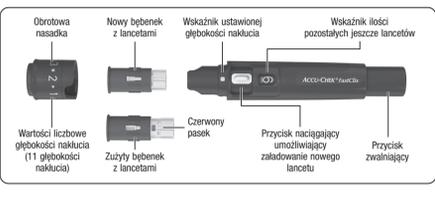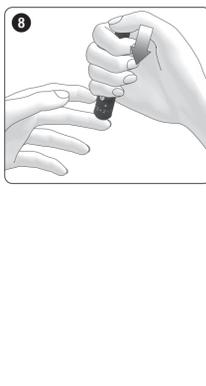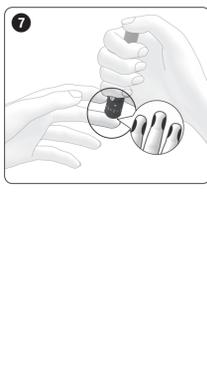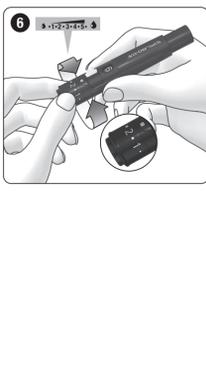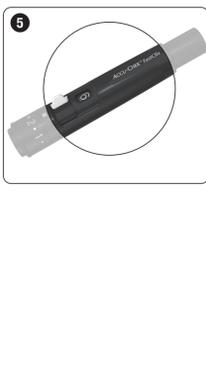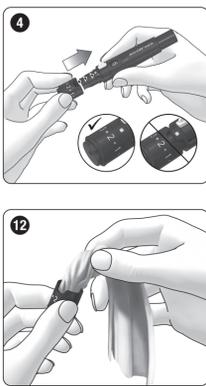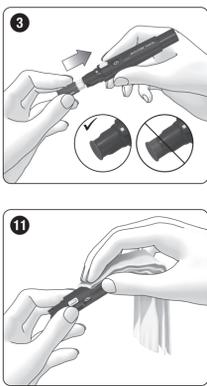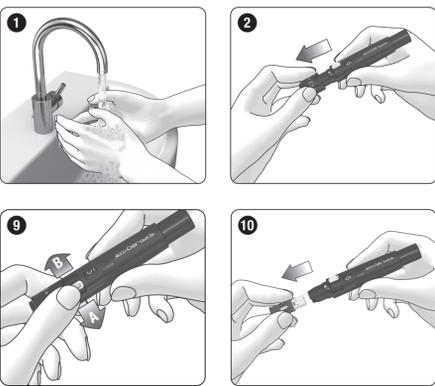

PL Instrukcja obsługi

Przewidywane zastosowanie


Nakuwacz Accu-Chek FastClix jest urządzeniem do łatwego, prawie bezbolesnego pozyskiwania krwi kapilarniej z opuszki palca. Nakuwacz Accu-Chek FastClix jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez jednego pacjenta! Wolno nim pozyskiwać krew zawsze tylko od tej samej osoby. Stosowanie nakuwacza przez inne osoby, również członków rodziny, lub wykorzystywanie go przez personel medyczny do pozyskiwania krwi od różnych pacjentów grozi zakażeniem z tego powodu nakuwacz ten nie jest przeznaczony do profesjonalnego stosowania w placówkach służby zdrowia. Wyrob ten jest sterylowy. Wyrob przeznaczony jest dla osób samodzielnie monitorujących swoją cukricę.

Lancet

W bębnie znajduje się sześć lancetów Accu-Chek FastClix. Bębenek z lancetami przeznaczony jest do użytku w połączeniu z nakuwaczem Accu-Chek FastClix. Bębenek z lancetami jest produktem jednorazowego użytku. Każdy lancet jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Bębenek Accu-Chek FastClix zawiera 6 lancetów i jest przeznaczony do użytku wraz z nakuwaczem Accu-Chek FastClix w celu prostego i prawie bezbolesnego pobrania krwi kapilarniej. Bębenek z lancetami jest wyposażony w 6 lancetów, z których każdy przeznaczony jest tylko do jednorazowego użytku. Każdy lancet ma osłonkę zabezpieczającą, która zapewnia skuteczny wyrob do pobrania próbki krwi. Lancet jest przeznaczony do napromieniania. Każdy bębenek z lancetami jest zabezpieczony przed ponownym użyciem.

Opis nakuwacza

W nakuwacza dostępnym jest 11 głębokości nakuć, które umożliwiają ustawienie odpowiednio do grubości skóry użytkownika. Naciśnięcie przycisku zwalniającego powoduje nacisgnięcie i automatyczne zwolnienie lancetu. Zwolniony lancet przekręca skórę. Bębenek z 6 lancetami wkłada się do nakuwacza. Umożliwia on 6-krotne pozyskanie krwi, każdorazowo z użyciem nowego, sterylnego lancetu, zanim będzie wymagana wymiana bębna na nowy.

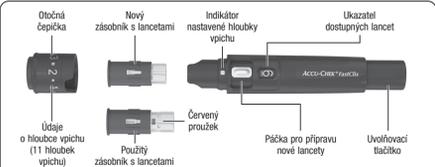

CS Návod k použití

Zamýňané použitie

Autolanceta
Autolanceta Accu-Chek FastClix je prostriedok ke snadnému a téměř bezbolestnému odběru kapilární krve ze spánků prstu. Autolanceta Accu-Chek FastClix je určena výhradně na použití pro jednoho pacienta. Krv s ním odebrat krev vždy jen jedné a té samé osobě. Pokud autolancetu použijete i jiné osoby, včetně rodinných příbuzných, nebo autolancetu použijete profesionální zdravotník v různých osobách k odběru krve, hrozí riziko přenosu infekce. Tato autolanceta neposkytuje nerušení profesionálnímu zdravotníku nebo zdravotnickým zařízením. Někdy se stává, že výrobek není sterilní.
Za účelům skupiny se používají osoby provádějící selfmonitoring diabetu.

Lanceta


V zásobníku se nachází šest lancetů Accu-Chek FastClix. Zásobník s lancetami je určen k použití s autolancetou Accu-Chek FastClix. Zásobník s lancetami je díl k jednorázovému použití. Každá lanceta v něm je určena pouze k jednomu použití. Lancetami s lancetami Accu-Chek FastClix obsahuje 6 lancetů a je určen k jednorázovému použití s autolancetou Accu-Chek FastClix k jednorázovému a téměř bezbolestnému odběru kapilární krve. Zásobník s lancetami je jednorázový prostředek a 6 lancetů je určeno pouze k jednomu použití. Každá lanceta je vybavena ochranným krytem, který zajišťuje její sterilitu stav až do prvního použití. Lancety jsou sterilizovány ozářením. Každý zásobník s lancetami je chráněn před opakovaným použitím.

Vlastnosti autolancety

Na autolancetu lze nastavit 11 různých hloubek vpichu a upravit tak hloubku vpichu podle struktury kůže. Pomocí uvolňovací tlačítka lze v jednom kroku automaticky nastavit a uvolnit lancetu. Při uvolnění vpichu struktura vaší pokožky. Pomocí spouštěcího tlačítka můžete v jednom kroku naplnit odberové pero a spouští lancetu. Při spuštění lanceta přiklene do osy prstu, ale i z jiných míst (z dlaň, předloktí, nadloktí, kyčle či stehna); jedná se o takzvané alternativní místa (anglicky: Alternative Site Testing, skrátené: AST). Aby bylo možné odebrat kapilární krev z jiných míst na těle, musíte nastavit

Před prvním použitím

Před oděním kapky krev ze spánku prstu si přečtěte tento návod k použití.

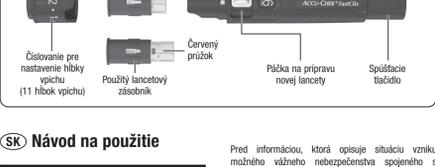

SK Návod na použitie

Určenie použitia

Odberové pero
Odberové pero Accu-Chek FastClix je zariadenie pre jednoduchú, takmer bezbolestnú odber kapilárnej krvi z brúsky prstu. Odberové pero Accu-Chek FastClix je určeno výhradně na použití pro jednoho pacienta. Krv s ním odebrat vždy jen jedné osobě. Nebezpečnost přenosu infekcí vzniká, ak odberové pero používajú iné ľudí, dokonca ani rodinní príbuzní. Odborný zdravotnícky personál nesmie na odberové pero ani v prípade profesionálneho zdravotníka používať odberové pero rôznych ľudí. Toto odberové pero preto nie je vhodné na profesionálne použitie v zdravotníckych zariadeniach a inštitúciách. Nie je to sterilný produkt. Cieľovou skupinou sú osoby vykonávajúce samostatnú diabetes.

Lanceta

6 lancetů Accu-Chek FastClix je v lancetovém zásobníku. Lancetový zásobník je určený na použití s odberovým perem Accu-Chek FastClix. Lancetový zásobník je pomůcka na jednorázové použití. Každá lanceta v něm je určena pouze k jednomu použití. Lancetový zásobník Accu-Chek FastClix obsahuje 6 lancetů a je určen na použití s odberovým perem Accu-Chek FastClix pro jednorázové a téměř bezbolestné odběry kapilární krve. Zásobník s lancetami je jednorázový prostředek a 6 lancetů je určeno pouze k jednomu použití. Každá lanceta má ochranný uzávěr, který zaručuje sterilitu stav až do prvního použití. Lancety su sterilizované žiarením. Použitý lancetový zásobník je chránený proti opakovanému použitiu.

Funkcie odberového pera

Odberové pero má 11 rôznych nastavení hlavy vpichu, takže môžete prispôbiť nastavenie hlavy vpichu štruktúre vašej pokožky. Pomocou spúšťacieho tlačítka môžete v jednom kroku naplniť odberové pero a spustiť lancetu. Pri spuštění lanceta přiklene do osy prstu, ale i z jiných míst (z dlaň, předloktí, nadloktí, kyčle či stehna); jedná se o takzvané alternativní místa (anglicky: Alternative Site Testing, skrátené: AST). Aby bylo možné odebrat kapilární krev z jiných míst na těle, musíte nastavit

Před prvním použitím

Přečtěte si tento návod na použití skř, až do brúsky prsta odberujete kvapku krvi.

ŚRODEK OSTROŻNOŚCI

Ryzyko przeniesienia obrażeń
Kontakt skóry z nakuwaczem, bębenkiem z lancetami lub lancetom może powodować podrażnienia. W przypadku pojawienia się podrażnienia lub stanu zapalnego skóry skonsultować się z lekarzem.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Opis lancetu została uszkodzona w wyniku użycia na twardest powierzchni. Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi. Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Jeżeli nakuwacz albo bębenek z lancetami spadł na podłogę albo był narzucony na twardą powierzchnię mechanicznie, sprawdź go pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub pęknięć. Nie używaj ich, jeżeli są uszkodzone.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Nastawienie głębokości nakuć
Można ustawić 11 głębokości nakuć (0,5 do 5,5). Słabym kwadrantem (wskaźnik ustawionej głębokości nakuć) na nakuwacza wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakuć. Im wyższa liczba, tym głębsze nakuć.

Przygotowanie
► Przed pozyskaniem krwi umyć dłonie ciepłą wodą i mydłem (poz. ➊). Dłonie należy dobrze wysuszyć. Zapobieganie zabrudzeniu miejsca wkładki i poprawi wynik pomiaru.

Włożenie bębna z lancetami
Aby wykonać nakuć do pozyskania krwi, należy naspiąć wtyczkę bębna z lancetami.

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).

► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

POZYSKIWANIE KROPLI KRWI

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).

► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

ŚRODEK OSTROŻNOŚCI

Ryzyko przeniesienia obrażeń
Kontakt skóry z nakuwaczem, bębenkiem z lancetami lub lancetom może powodować podrażnienia. W przypadku pojawienia się podrażnienia lub stanu zapalnego skóry skonsultować się z lekarzem.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Opis lancetu została uszkodzona w wyniku użycia na twardest powierzchni. Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi. Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Jeżeli nakuwacz albo bębenek z lancetami spadł na podłogę albo był narzucony na twardą powierzchnię mechanicznie, sprawdź go pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub pęknięć. Nie używaj ich, jeżeli są uszkodzone.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Nastawienie głębokości nakuć
Można ustawić 11 głębokości nakuć (0,5 do 5,5). Słabym kwadrantem (wskaźnik ustawionej głębokości nakuć) na nakuwacza wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakuć. Im wyższa liczba, tym głębsze nakuć.

Przygotowanie
► Przed pozyskaniem krwi umyć dłonie ciepłą wodą i mydłem (poz. ➊). Dłonie należy dobrze wysuszyć. Zapobieganie zabrudzeniu miejsca wkładki i poprawi wynik pomiaru.

Włożenie bębna z lancetami
Aby wykonać nakuć do pozyskania krwi, należy naspiąć wtyczkę bębna z lancetami.

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).

► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

POZYSKIWANIE KROPLI KRWI

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).

► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

ŚRODEK OSTROŻNOŚCI

Ryzyko przeniesienia obrażeń
Kontakt skóry z nakuwaczem, bębenkiem z lancetami lub lancetom może powodować podrażnienia. W przypadku pojawienia się podrażnienia lub stanu zapalnego skóry skonsultować się z lekarzem.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Opis lancetu została uszkodzona w wyniku użycia na twardest powierzchni. Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi. Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Jeżeli nakuwacz albo bębenek z lancetami spadł na podłogę albo był narzucony na twardą powierzchnię mechanicznie, sprawdź go pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub pęknięć. Nie używaj ich, jeżeli są uszkodzone.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Nastawienie głębokości nakuć
Można ustawić 11 głębokości nakuć (0,5 do 5,5). Słabym kwadrantem (wskaźnik ustawionej głębokości nakuć) na nakuwacza wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakuć. Im wyższa liczba, tym głębsze nakuć.

Przygotowanie
► Przed pozyskaniem krwi umyć dłonie ciepłą wodą i mydłem (poz. ➊). Dłonie należy dobrze wysuszyć. Zapobieganie zabrudzeniu miejsca wkładki i poprawi wynik pomiaru.

Włożenie bębna z lancetami
Aby wykonać nakuć do pozyskania krwi, należy naspiąć wtyczkę bębna z lancetami.

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).

► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

POZYSKIWANIE KROPLI KRWI

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).

► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

ŚRODEK OSTROŻNOŚCI

Ryzyko przeniesienia obrażeń
Kontakt skóry z nakuwaczem, bębenkiem z lancetami lub lancetom może powodować podrażnienia. W przypadku pojawienia się podrażnienia lub stanu zapalnego skóry skonsultować się z lekarzem.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Opis lancetu została uszkodzona w wyniku użycia na twardest powierzchni. Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Lancet może być używany wyłącznie do pozyskiwania kropli krwi. Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Jeżeli nakuwacz albo bębenek z lancetami spadł na podłogę albo był narzucony na twardą powierzchnię mechanicznie, sprawdź go pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub pęknięć. Nie używaj ich, jeżeli są uszkodzone.

Ryzyko odniesienia obrażeń
Nie kierować nakuwacza w stronę twarzy ani w stronę innych osób.

Nastawienie głębokości nakuć
Można ustawić 11 głębokości nakuć (0,5 do 5,5). Słabym kwadrantem (wskaźnik ustawionej głębokości nakuć) na nakuwacza wskazuje aktualnie nastawioną głębokość nakuć. Im wyższa liczba, tym głębsze nakuć.

Przygotowanie
► Przed pozyskaniem krwi umyć dłonie ciepłą wodą i mydłem (poz. ➊). Dłonie należy dobrze wysuszyć. Zapobieganie zabrudzeniu miejsca wkładki i poprawi wynik pomiaru.

Włożenie bębna z lancetami
Aby wykonać nakuć do pozyskania krwi, należy naspiąć wtyczkę bębna z lancetami.

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).

► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

POZYSKIWANIE KROPLI KRWI

OSTRZEŻENIE
Lancety w uszkodzonym bębnie mogą nie być już sterylne. Jeżeli bębenek z lancetami jest uszkodzony, np. pęknięty, nie używać go do pozyskiwania krwi.

► Zjąć nasadkę z nakuwacza (zob. ➋).
► Włożyć do nakuwacza nowy bębenek z lancetami skierowany białą końcówką do jego wnętrza (zob. ➌).

Podczas wkładania bębna z lancetami nie należy sprządać, czy lancetki wystają z bębna. Podczas wkładania bębna z lancetami nie opierać przycisku zwalniającego na dno powierzchni, np. na blacie stołu. Może to prowadzić do uruczenia lancetu i nieumyślnego uszkodzenia skóry.

Prawidłowo włożony bębenek z lancetami jest całkowicie osłonięty w nakuwacza z wystającą jedynie przednią krawędzią (zob. ➍).



► Ponownie nasadzić nakuwacz. Znajdujące się na krawędzi nasadki wybrzożenie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakuć (słabym kwadrantem) muszą się przy tym znaleźć (patrz ➎).

Nasadka jest nakładana prawidłowo, jeśli nie nasunięta jest na opakowaniu obok symbolu z

ŚRODEK OSTROŻNOŚCI

Ryzyko przeniesienia obrażeń
Kontakt skóry z nakuwaczem, bębenkiem z lancetami lub lancetom może powodować podrażnienia.

Sprožilna naprava in lanceta
Lancetar i lanceta

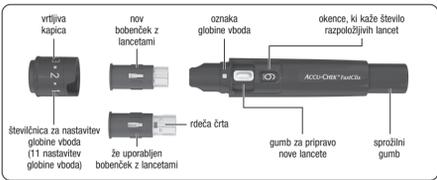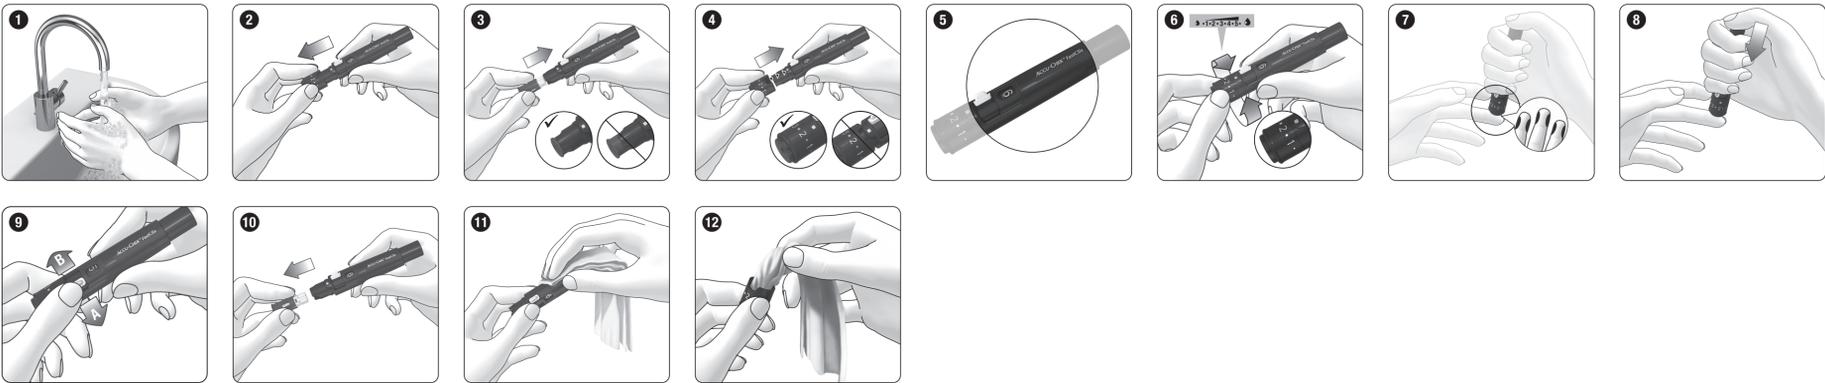

Navodila za uporabo

Previdna uporaba


Sprožilna naprava
Sprožilna naprava Accu-Chek FastClix je naprava za enostaven in neboleč odvzem kapilare krvi iz prstnih blazin. Sprožilna naprava Accu-Chek FastClix je samo za osebno uporabo! Za odvzem krvi se lahko uporabljate samo pri eni osebi. Če sprožilno napravo uporabljate tudi drugi ljudje, vključno z družinskimi člani, ali če jo zdravstvene osebe uporabljajo za odvzem krvi pri več različnih osebah, obstaja tveganje prenosa okužb. Zato ta sprožilna naprava ni primerna za profesionalno uporabo v zdravstvenih ustanovah. Izdelek ni sterilan. Ciljna skupina uporabnikov tega izdelka so ljudje, ki živjajo samostojno ravnj glukoze v krvi.

Lanceta
V bobenčku je šest lancet Accu-Chek FastClix. Bobenček z lancetami je namenjen za uporabo v sprožilni napravi Accu-Chek FastClix. Bobenček z lancetami je za enkratno uporabo. Vsaka lanceta v njem se uporablja le enkrat. V bobenčku z lancetami Accu-Chek FastClix je 6 lancet in namenjen je uporabi s sprožilno napravo Accu-Chek FastClix za enostaven in neboleč odvzem kapilare krvi. Bobenček z lancetami je izdelek za enkratno uporabo, tako da je vsaka od 6 lancet v njem le za enkratno uporabo. Vsaka lanceta ima zaščitno kapico, ki zagotavlja sterilne pogoje do prve uporabe. Lancete so sterilizirane z izžarevanjem. Že uporabljen bobenček z lancetami je zaščiten pred ponovno uporabo.

Značilnosti sprožilne naprave
Sprožilna naprava ponuja 11 nastavitev globoine voda, tako da globoina voda lahko prilagodite glede na strukturo svoje kože. S sprožilnim gumbom lahko v enem koraku napnete sprožilno napravo in sprožite lanceto. Ko se lanceta sproži, prede kožo. V sprožilno napravo vstavite robove s 6 lancetami. Z novimi, sterilnimi lancetami si lahko šestkrat odvzame vzorce krvi, potem pa je bobenček treba zamenjati.

Pred prvo uporabo

Ta navodila za uporabo prebrajte. Še preden odvzamete kapilčno krvi iz vrste prsta.

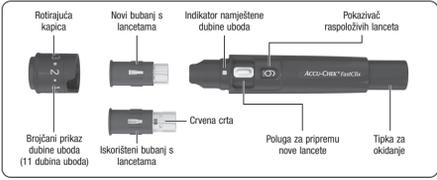

Upute za uporabo

Previdna namjena

Lancetar
Lancetar Accu-Chek FastClix je uređaj za jednostavno, gotovo bezbolno vadenje uzorka kapilare krvi iz jagodica prstiju. Lancetar Accu-Chek FastClix je predviđen samo za jednokratnu uporabu. Svaaka lanceta predviđena je samo za jednokratnu uporabu. Bubaanj zajednički koristi više osoba, čak i onda kada su to članovi iste obitelji, ili kada ih liječnik koristi za uzimanje uzorka krvi od više različnih osoba. Zato postoji rizik od prijenosa infekcije. Ovak lancetar stoga nije prikladan za profesionalno korištenje u zdravstvenim ustanovama. Ovak proizvod nije sterilan. Osobe koje provode samokontrolu dijabetesa smatraju se ciljnom populacijom.

Lanceta
Bubanj sadrži šest lanceta Accu-Chek FastClix. Bubaanj s lancetama predviđen je za uporabu z s lancetom Accu-Chek FastClix. Bubaanj s lancetama je dio predviđen za jednokratnu uporabu. Svaaka lanceta predviđena je samo za jednokratnu uporabu. Bubaanj zajednički koristi više osoba, čak i onda kada su to članovi iste obitelji, ili kada ih liječnik koristi za uzimanje uzorka krvi od više različnih osoba. Zato postoji rizik od prijenosa infekcije. Ovak lancetar stoga nije prikladan za profesionalno korištenje u zdravstvenim ustanovama. Ovak proizvod nije sterilan. Osobe koje provode samokontrolu dijabetesa smatraju se ciljnom populacijom.

Karakteristike lancetara
Lancetar omogućuje 11 različitih dubina uboda tako da se dubina uboda može prilagoditi stranju vaše kože. Pomoću tipke za okidanje možete u jednom koraku lancetar napeti i otpustiti lancetu. Prilikom otpuštanja lanceta probija kožu. Umehitate bubanj sa 6 lanceta u lancetar. Možete odaviti 6 vadenja krvi, svaki put sa svježim lancetom, nakon čega zamjenite bubanj.

Prije nego počnete

Pročitajte ove upute za uporabu prije nego što izvadite kapilčno krvi iz vrste prsta.

Nevarnost poškodbe
Nekateri deli sprožilne naprave, na primer gumb za napenjanje, se med uporabo lahko sprožijo. Sprožilne naprave ne usmerjajte v obraz ali druge ljudi.

Če je sprožilna naprava ali bobenček z lancetami padla/padel na tla ali je bil/a izpostavljen/a kateri drugi mehanski obremenitvi, jo/jga pregledajte glede poškodb, npr. razpok. Ne uporabljajte, če so poškodovane. V sprožilno napravo Accu-Chek FastClix vstavite samo bobenček z lancetami Accu-Chek FastClix. Druge lancete ali bobenčke z lancetami lahko povzročijo neuporabno delovanje sprožilne naprave ali jo trajno poškodujejo.

Priprava
► Pred odvzemanj krvi si roke umijte s toplo vodo in milom (glejte 1). Roke dobro osušite. To pripomore k zmanjšanju tveganja za okužbo vboodnega mesta in obtem spodbudi prekrvitev.

Vstavitve bobenčka z lancetami
Pred odvzemanj krvi je treba v sprožilno napravo vstaviti bobenček z lancetami.

OPOROILRO
Nevarnost okužbe
Lancetar v poškodovanem bobenčku verjetno niso več sterilne. Če je bobenček z lancetami poškodovan ali razpokan, ga ne uporabljajte za odvzem vzorca krvi. ► S sprožilno napravo snameite kapilco (glejte 3).

► V sprožilno napravo vstavite – z belim koncem naprej – nov bobenček z lancetami (glejte 4). Ko vstavite bobenček z lancetami, ne pritisnite istočasno sprožilnega gumba. Sprožilna naprava z vstavljenim bobenčkom ne odlože na mizo na sprožilni gumb. S tem lahko sprožite lanceto in se nenamerno zbadate. Bobenček z lancetami je pravilno vstavljen, če je v celoti v sprožilni napravi in izstopa spredaj le še rob (glejte 5).

► Ponovno natakite kapilco. Zarez na robu kapilce se mora umetiti z izbočeni izrisom oznake za globoino vodo (levo strani kvadrat) (glejte 6). Kapilca je pravilno natakljena, če je potisnjena do konca in se pri tem silno zasloči.

Konca se lahko namesti do lonca, le če je bobenček z lancetami v celoti v sprožilni napravi. Kapilce ne namestajte na silo, saj tako lahko poškodujete kapilco in sprožilno napravo. Namesto tega popravite namestitev bobenčka z lancetami.

► Sprožilno napravo čvrsto pritisnite na izbrano mesto voboda (glejte 7). ► Prilicite do lonca na sprožilni gumb (glejte 8). Lanceta se sproži in vodo v kožo. ► Da spodbudite oblikovanje kapilce krvi, nežno masirajte prst v smeri proti prstni blazini. Koilčna krvi, ki se pojavja na mestu voboda, je odvisna od globoine voboda in moči pritiska sprožilne naprave na prst.

Nastavitve globoine voda
Izbrati lahko med 11 nastavitvami globoine voda (od 0,5 do 5,5). Srebrni kvadrat (oznaka za nastavljeno globoino vodo) na sprožilni napravi označuje trenutno nastavitev globoine voda. Višja je številka, globlja je nastavitve globoine voda.

OPOROILRO
Nevarnost poškodbe
Če je globoina voda pregloboka, lahko vbood poškoduje otroka. Pred prvo uporabo sprožilne naprave na otrocih se posvetujte z vašim zdravstvenim osebje. Začnite z najmanjšo globoino vodo. ► Zavrtite kapilco, da se prikaže oznaka z želeno globoino vodo (glejte 9).

Odvzem kapilčne krvi
OPOROILRO
Nevarnost okužbe
Lanceta je bila za odvzem krvi uporabljena večkrat. Da preprečite prenos okužb, vsako lanceto za odvzem krvi uporabite le enkrat.

OPOROILRO
Nevarnost okužbe
Če je globoina voda prevelika, ubod može ozlediti djetje. Lanceta je bila za odvzem krvi uporabljena večkrat. Da preprečite prenos okužb, vsako lanceto za odvzem krvi uporabite le enkrat.

OPOROILRO
Nevarnost okužbe
Če je globoina voda prevelika, ubod može ozlediti djetje. Lanceta je bila za odvzem krvi uporabljena večkrat. Da preprečite prenos okužb, vsako lanceto za odvzem krvi uporabite le enkrat.

OPOROILRO
Nevarnost okužbe
Če je globoina voda prevelika, ubod može ozlediti djetje. Lanceta je bila za odvzem krvi uporabljena večkrat. Da preprečite prenos okužb, vsako lanceto za odvzem krvi uporabite le enkrat.

OPOROILRO
Nevarnost okužbe
Če je globoina voda prevelika, ubod može ozlediti djetje. Lanceta je bila za odvzem krvi uporabljena večkrat. Da preprečite prenos okužb, vsako lanceto za odvzem krvi uporabite le enkrat.

Če ste pridobili premalo krvi, poskusite ponovno in tokrat sprožilno napravo pritisnite močneje. Če krvi še vedno ni dovolj, ponovite postopek z nastavitvijo večje globoine voda. Višja je številka, globlja je nastavitve globoine voda. Če pridobite prevelik vzorec krvi, zmanjšajte globoino vodo.

► Takoj po odvzemu krvi izmerite raven glukoze v krvi skladno z navodili za uporabo merilnika. Pripočnajte, da potem mesto voboda zaščitate, da ostane čisto.

Manjševitev novo lanceto
Sprožilna naprava je zdaj pripravljena za uporabo. Okence polja gumba kaže eno razpoložljivo lanceto manj, na primer 5 namesto 6.

► Vasko lanceto zamenjajte po opisanem postopku. Vedno, kadar je pripravljena nova lanceta, se število razpoložljivih lancet v okencu zmanjša za eno, na primer 4 s na 3. Ko namestite šest, zadnjo lanceto, se v okencu prikaže številka 1.

Zamenjava porabljenega bobenčka z lancetami
Potem ko porabite šest, zadnjo lanceto, je treba porabljen bobenček zamenjati z novim. ► S sprožilno napravo snameite kapilco (glejte 3).

► Iz sprožilne naprave izvlecite bobenček z lancetami (glejte 4).

Če je globen bobenček z lancetami porabljen, je na belim vrhu rdeča črta. Že uporabljen bobenček z lancetami ima vgrajen varnostni mehanizem, ki onemogoča ponovno uporabo. Porabljen bobenček z lancetami lahko odvzame med gospodinjstve odpadke oziroma po predpisih, ki veljajo v državi, kjer živite.

► Vstavite nov bobenček z lancetami (glejte razdelek Vstavljanje bobenčka z lancetami).

Pogoji delovanja
Sprožilno napravo in druge pripomočke uporabljajte v naslednjih delovnih pogojih:

- v temperaturni območju: od +5 do +45 °C
- v območju relativne vlažnosti: od 5 do 90 %

Shranjevanje sprožilne naprave in bobenčkov z lancetami
Sprožilno napravo uporabljajte le z namenečno kapilco. Če kapilca ni namenečena, lanceta zvede pregloboko in povzroči nepotrebno nelagodje.

► Sprožilno napravo čvrsto pritisnite na izbrano mesto voboda (glejte 7).

► Prilicite do lonca na sprožilni gumb (glejte 8). Lanceta se sproži in vodo v kožo.

► Da spodbudite oblikovanje kapilce krvi, nežno masirajte prst v smeri proti prstni blazini. Koilčna krvi, ki se pojavja na mestu voboda, je odvisna od globoine voboda in moči pritiska sprožilne naprave na prst.

Čiščenje in dezinfekcija sprožilne naprave in kapilce
PREVIDNOSTNI UKREP
Nevarnost okužbe
Sprožilna naprava in kapilca sta lahko prsti v stik s krvjo.

Da bi preprečili prenos okužb, očistite in razkužite sprožilno napravo in kapilco vedno, preden je kdo drug vzame v roke, na primer da bi vam pomagal.

Da bi preprečili prenos okužb, morate redno čistiti in razkuževati sprožilno napravo in kapilco:

- vsaj 1-krat na teden,
- če so na sprožilni napravi ali kapici ostanki krvi,
- vsesje, preden kdo drug vzame v roke sprožilno napravo, na primer da bi vam pomagal.

Uporabite krpe, ki ne puščajo vlakn in v katere sprožilno napravo lahko v celoti zavijete, ter vodo in sprožilno napravo lahko v kapilco razkužite, jo morate najprej očistiti, da odstranite kri in drugo umazanijo. Da sprožilne naprave in kapilce ne poškodujete:

- Sprožilne naprave in kapilce ne potopite v tekočino.
- Za čiščenje uporabite samo vodo, za razkuževanje pa samo 70-odstotni izopropanol.

► S sprožilno napravo snameite kapilco (glejte 3).

► Iz sprožilne naprave izvlecite bobenček z lancetami (glejte 4).

► Sprožilno napravo in kapilco obrišite še s suho krpo.

Razkuževanje
► Krpo dobro navlažite s 70-odstotnim izopropanolom.

- Sprožilno napravo in kapilco temeljito obrišite po 2 minuti vsako. Sprožilno napravo obrišite samo po zunanji strani, kapilco pa po zunanji in notranji površini.
- Ponovno natakite kapilco.
- Temeljito obrišite 2 minute zasebno lancetar i kapilco.
- Sprožilno napravo pustite zavilo 8 minut.
- Nato odvijte sprožilno napravo in počakajte, da se posuši na zraku.

Odlaganje sprožilne naprave med odpadke
PREVIDNOSTNI UKREP
Nevarnost okužbe
Sprožilna naprava je prišla v stik s krvjo, med odpadke pa je bila odložena nevarna. Da preprečite prenos okužb, uporabljajte sprožilno napravo zavrtilo kot kučni material v skladu s predpisi, ki veljajo v državi, kjer živite.

Med odvzemanj kapilce krvi lahko sprožilna naprava pride v stik s krvjo. Uporabljen sprožilna naprava je potencialni vir okužbe.

Neuporabljen sprožilno napravo zavrtite med plastične odpadke.

Za informacije o pravilnem odlaganju se obrnite na zadnji lokalni urad.

Druge vobodna mesta za odvzem krvi
Kapilarno kri za merjenje ravni glukoze v krvi lahko odvzamete ne le iz prstne blazince, ampak tudi drugje (n. št. dlan, podlaktični nadlaktič, stegen ali meč), to imenujemo merjenje iz drugih vobodnih mest (angl.

Uporabljajte navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo elektronskega navodila za uporabo. Previdno, upoštevajte varnostna opozorila v priloženih navodilih za uporabo.

Uporabno do Sterilizirano z izžarevanjem

Samo za enkratno uporabo En bolnik – večkratna uporaba

Medicinski pripomoček Proizvajalec

Edinstveni identifikator pripomočka Kataloška številka

Številka serije Skladno z določami veljavne zakonodaje EU

Alternativne Site Testing, skrajšano: AST). Da bi lahko odvzeli kapilarno kri iz drugih vobodnih mest, morate običajno kapilco zamenjati s posebno, AST-kapilco Accu-Chek FastClix.

Če želite naročiti sprožilno napravo Accu-Chek FastClix, bobenček z lancetami Accu-Chek FastClix ali AST-kapilco Accu-Chek FastClix, se obrnite na Center za pomoč uporabnikom in servis (glejte razdelek Center za pomoč uporabnikom in servis).

Informacije za naročanje
Če želite naročiti sprožilno napravo Accu-Chek FastClix, bobenček z lancetami Accu-Chek FastClix ali AST-kapilco Accu-Chek FastClix, se obrnite na Center za pomoč uporabnikom in servis (glejte razdelek Center za pomoč uporabnikom in servis).

Poročanje o resnih zapletih
Za bolnika uporabnika tretjo stranjo v Evropi ungi in v državi z enako zakonsko ureditvijo: če med uporabo tega pripomočka ali kot posledica njegove uporabe nastane resen zaplet, poročajte o njem proizvajalcu in ustreznemu nacionalnemu organu.

Zadnja sprememba
2021-03

Center za pomoč uporabnikom in servis
Slovenija
Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek Brezplačen telefon: 080 182 32
www.accu-check.si



ACCU-CHEK in FASTCLIX sta blagovni znaki družbe Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com



Rizik od ozledje
Mlade materske 11 dubina uboda (od 0,5 do 5,5). Srebrni kvadrat (indeksirane dubine uboda) na lancetaru pokazuje namršteno dubino uboda. Što je večji broj, to je veća dubina uboda.

Ako još nimate iskustva s ovim lancetom, upotrebljavajte samo lancete umetne rane dubine uboda, npr. dubinu uboda 2.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

Vadenje kapilčne krvi
OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

Namještanje dubine uboda
Mlade materske 11 dubina uboda (od 0,5 do 5,5). Srebrni kvadrat (indeksirane dubine uboda) na lancetaru pokazuje namršteno dubino uboda. Što je večji broj, to je veća dubina uboda.

Ako još nimate iskustva s ovim lancetom, upotrebljavajte samo lancete umetne rane dubine uboda, npr. dubinu uboda 2.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

Vadenje kapilčne krvi
OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

OPOROILRO
Rizik od infekcije
Lanceta je upotrijebljena više puta za vadenje krvi. Kako bi spriječili prijenos infekcija, upotrijebite lancetu samo jednom za vadenje krvi.

Ako je dobivena količina krvi premala, pokušajte ponovo, ali ovdje puta lancetar jače pritisnite uz kožu. Ako još uvijek ne dobivate dovoljnu količinu krvi, ponovite postupak s većom dubinom uboda.

Ako dobivate previše krvi, smanjite dubinu uboda. ► Izvršite mjerenje glukoze u krvi odmah nakon što ste izvadili krv prema uputama za uporabu vašeg aparata za mjerenje glukoze u krvi.

Nakon vadenja krvi preporučujemo je zaštititi mjesto uboda kako biste ga održali čistim.

Priprema nove lancete
Nakon što se pomoću lancetara izvadi uzorak krvi, za sljedeće vadenje krvi potrebna vam je nova lanceta.

► Pomaknite polugu sa strane lancetara do kraja u smjeru A i opt u smjeru B (vidi sliku 9).

Slijedeća lanceta sada je spremna za uporabu. Prikazani broj raspoloživih lanceta uz polugu sada pokazuje jednu lancetu manje, npr. 5 umjesto ranijih 6.

► Ponovite prethodno opisani postupak pri svakom mijenjanju lancete.

Nakon svake promjene lancete pokazivač raspoloživih lanceta pokazuje jednu lancetu manje, npr. sada 3 umjesto ranijih 4. Kada ste pripremili šestu, i time posljednju lancetu, pokazivač pokazuje 1.

Mijenjanje iskorisćenog bubnja s lancetama
Kada ste upotrijebili šestu, tj. zadnju lancetu, potrebno je zamijeniti cijeli bubanj s lancetama novim.

► Skinite kapilcu s lancetara (vidi sliku 3).

► Izvadite bubanj s lancetama iz lancetara (vidi sliku 4).

Kod iskorisćenog bubnja s lancetama na bijelom cilindru vidljiva je crvena crta. Iskorisčeni bubanj s lancetama ima sigurnosni mehanizam koji onemogućuje ponovno umetanje bubnja. Iskorisčeni bubanj s lancetama možete zbrinuti s kućnim otpadom, ukoliko u vašoj zemlji to nije drugačije propisano.

► Umehitate novi bubanj s lancetama (vidi sliku 5) u lancetar.

Dvjetri rada
Upotrebljavajte lancetare i pribor pod sljedećim radnim uvjetima.

- Raspon temperature: +5 do +45 °C
- Raspon relativne vlažnosti zraka: 5 do 90 %

Čuvanje lancetara i bubnja
Nemojte čuvati lancetar i bubanj s lancetama na visokim temperaturama, npr. u zagrijanom automobilu. To može utjecati na rad lancetara i bubnja s lancetama.